


W celu pobrania certyfikatu do produktu **POCH (Avantor Performance Materials)**, należy:

1. wejść na stronę <http://www.poch.com.pl/1/atesty-jakosciowe,0,0>
2. podać numer asortymentu oraz numer serii i kliknąć 'Szukaj'

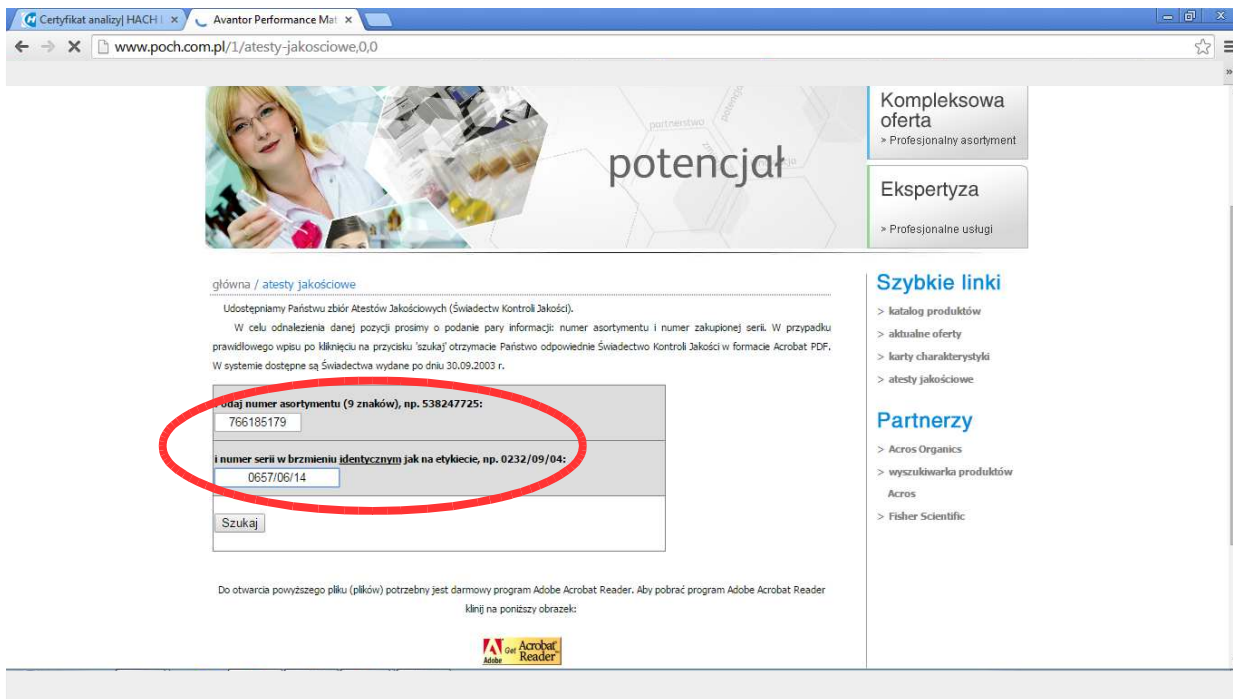

www.poch.com.pl/1/atesty-jakosciowe,0,0

potencjał

Kompleksowa oferta  
» Profesjonalny asortyment

Ekspertyza  
» Profesjonalne usługi

główna / atesty jakościowe


Udostępniamy Państwu zbiór Atestów Jakościowych (Świadectw Kontrol Jakiści).

W celu odnalezienia danej pozycji prosimy o podanie pary informacji: numer asortymentu i numer zakupionej serii. W przypadku prawidłowego wpisu po kliknięciu na przycisku 'szukaj' otrzymacie Państwo odpowiednie Świadectwo Kontrol Jakiści w formacie Acrobat PDF. W systemie dostępne są Świadectwa wydane po dniu 30.09.2003 r.

Wprowadź numer asortymentu (9 znaków), np. 538247725:  
766185179

Wprowadź numer serii w brzmieniu identycznym jak na etykiecie, np. 0232/09/04:  
0657/06/14

Szukaj

Do otwarcia powyższego pliku (plików) potrzebny jest darmowy program Adobe Acrobat Reader. Aby pobrać program Adobe Acrobat Reader  
Kliknij na poniższy obrazek:  


Szybkie linki  
» katalog produktów  
» aktualne oferty  
» karty charakterystyki  
» atesty jakościowe

Partnerzy  
» Acros Organics  
» wyszukiwarka produktów  
Acros  
» Fisher Scientific

3. na ekranie wyświetli się dokument, który można zapisać w formie pliku pdf lub bezpośrednio wydrukować



www.poch.com.pl/1/atesty-jakosciowe/atest\_2.php?nr\_asort=766185179&nr\_serii=0657/06/14 - Google Chrome

www.poch.com.pl/1/atesty-jakosciowe/atest\_2.php?nr\_asort=766185179&nr\_serii=0657/06/14

AVANTOR  
PERFORMANCE MATERIALS

Świadełstwo KONTROLI JAKOŚCI

Gliwice, dn. 01.07.2014

766185179 Roztwór buforowy pH 9,00 +/- 0,05      Gatunek:  
Dokument normatywny: SJ-5170 wg ZN-91/MP/OCh-592      Nr serii: 0657/06/14

Parametr	Jednostka	Wymagania	Wynik
Wygląd zewnętrzny		bezbarna, klarowna ciecz	odpowiada
pH (20°C)		8,95-9,05	odpowiada

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: Czerwiec 2016

Zatwierdził:  
SPECJALISTA WIODĄCY  
*Eliżeta Rutkowska*  
Eliżeta Rutkowska

Download and Print icons highlighted with a red circle.